

МИШКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

МОДЕЛЬ Р 3

Детский компрессорный небулайзер (ингаллятор)




PG

им 24

- Допустимы изменения количества оборотов двигателя, при этом средние характеристики прибора являются неизменными.
- Производитель, сборщик и Центр сервисного обслуживания несут ответственность за безопасность изделия только в случае, если:
- Сборка, испытание и ремонт были выполнены уполномоченным персоналом.
- Электрическая сеть соответствует действующим нормативам.
- Были выполнены все инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Производитель освобождается от ответственности в случае ущерба при неисправностях, ошибочном или нерациональном использовании прибора и его аксессуаров.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вставить кабель электропитания 6 в розетку, первоначально убедившись в том, что напряжение питания соответствует 220 В.



- Надеть пистон 14 (A-B-C), в зависимости, от необходимого режима на форсунку, расположенную в нижней части небулайзера 12.
- Влить лекарственное средство в нижнюю часть небулайзера 12 (см. инструкцию «по эксплуатации небулайзера»).
- Повернуть верхнюю часть небулайзера 11 по направлению часовой стрелки для закрытия небулайзера.
- Сверху надеть на небулайзер респираторную маску 10 или мундштук 9.
- При использовании силиконовой трубы 8, надеть на один из её концов нижнюю часть небулайзера 12.
- Другой конец силиконовой трубы 8 присоединить к штекеру соединения трубы 4, расположенному внизу на корпусе 1.
- Включить прибор, расположив выключатель 3 на символ ВКЛ.
- Для выключения расположить выключатель 3 на символ ВЫКЛ.
- Лечение должно производиться сидя, удобно расположившись в прямом положении. При использовании респираторной маски 10 необходимо, чтобы она плотно прилегала к лицу. Дышать медленно делая короткую паузу при завершении каждого выдоха и затем, производя быстрый вдох. Мундштук 9 при использовании должен держаться между зубами, сокнув трубу. При этом необходимо дышать гортом.
- Возможно регулирование потока воздуха регулятором 13 (в виде колесика), расположенным в верхней части небулайзера 11.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕБУЛАЙЗЕРА

Сертификат Соответствия Европейским стандартам CE 6434, нормам Европейского регистрационного общества по аэрозольтерапии EN 13544-1




КОМПРЕССОРНЫЙ ИНГАЛЯТОР

Модель Р3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

компрессорного ингалятора (небулайзера)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

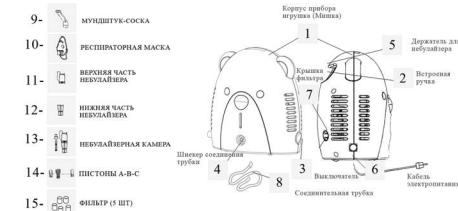

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочитать предупреждения, содержащиеся в данной инструкции и хранить её для последующих консультаций.

- Хранить прибор вдали от детей и людей, не умеющих с ним обращаться.
- Хранить вдали от деталей компоненты упаковки (картонная коробка, пластиковые пакеты и т.д.)
- Не использовать 100 % этифирные масла.
- Использовать прибор для аэрозольных ингаляций с лекарственными средствами только по предписанию врача.
- Не использовать соединения и аксессуары, не предусмотренные производителем.

- Не использовать прибор при наличии воспалительных смесей, таких как кислородные и т.д.
- Не использовать прибор, если после снятия упаковки имеются повреждения, которые могут привести к нарушению герметичности или транспортировке. Обратиться в Центр Технического Обслуживания при любых дефектах.
- Не использовать прибор при повреждении кабеля.
- Хранить прибор в кабеле вдали от источников тепла.
- Не засорять воздушообменный прибор.
- Рекомендуется персональное использование аксессуаров.
- После процедуры не оставлять остатки лекарственных средств в небулайзере.
- Чистить, а также производить операции по очистке или техническому обслуживанию только после извлечения питающего кабеля из розетки.
- Не опускать прибор в воду или другую жидкость и не использовать его при мытье или души.
- Хранить прибор в сухом, защищенном от влаги месте.
- При загрязнении фильтра необходимо заменить его на новый.
- В случае случайного падения прибора в воду необходимо извлечь кабель из розетки. Извлечь прибор из воды и в дальнейшем не использовать его.
- Не использовать прибор мокрыми руками.
- Убедиться, что прибор расположен на устойчивой и прочной поверхности для предотвращения возможных повреждений.
- Не использовать прибор во время сна.
- Не засорять решетки охлаждения.
- В случае неисправности или плохой работы прибора необходимо извлечь вилку из розетки. Ремонт должен производиться только в уполномоченных Центрах Технического Обслуживания.
- После проведения процедуры необходимо удалить все части прибора, представляющие опасность, особенно для детей, которые могут использовать их для игры.
- Установка должна производиться согласно инструкции производителя. Ошибочная установка может причинить вред людям, животным или предметам, по отношению к которым производитель не может быть признан ответственным.
- В случае неиспользования, прибор должен быть отключен от сети.

ВНИМАНИЕ!

- Рекомендуется иметь альтернативный прибор или лекарственное средство (по предписанию врача) при невозможности завершения терапии в случае отсутствия непрерывно.
- Терапия всегда предписывается врачом, который назначает тип лекарственного средства, дозировку и график проведения процедур.
- Прибор предусмотрен для максимального периода постоянной работы 30 минут. После данного периода постоянной работы прибор должен быть выключен на 30 минут.

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если в течение терапии необходима пауза, можно выключить небулайзер посредством выключателя 3. Лечение заканчивается, когда распылитель начинает подавать аэрозоли непрерывно.
- При завершении лечения необходимо тщательно произвести чистку так, как описано в разделе «ЧИСТКА». При завершении лечения и не использовании прибора вынуть вилку из сети питания.

ЧИСТКА

- Вынуть вилку из розетки. После каждого применения выполнять чистку всех аксессуаров (рис. 8, 10, 11, 12 и 14).
- Для очистки небулайзера пронитить раздел «ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕБУЛАЙЗЕРА».
- Очень важно: респираторная маска 10, соединительная силиконовая трубка 8, мундштук 9, части небулайзера 11 и 12 не должны помещаться в клиническую воду. Чистка может производиться при помощи специальных химических дезинфицирующих средств. В домашних условиях, возможно, промыть аксессуары в мыльном растворе и затем в пропицкой воде. Затем при необходимости произвести дезинфекцию.
- Для очистки небулайзера от накипи рекомендуется использовать раствор УНИФИЛТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства. Возможен в другой способ: испытывать аксессуары притертой для воздействия на полирезином, из которого изготовлены аксессуары.
- После чистки все аксессуары необходимо тщательно просушить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При частом использовании прибора фильтр воздуха должен заменяться один раз в 6 месяцев. Для замены фильтра необходимо снять на рамке под крышки фильтра 7. Вынуть старый фильтр и заменить его новым. Старый фильтр, возможно, окрасить в мокром состоянии, затем тщательно промыть под струей проточной воды, высуширь и убрать до следующей замены.
- Выставить крышки фильтра 7 на место.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия подразумевает возможность дефектов производства или материалов в случае, если они не были вызваны злоупотреблением или неисправностями персоналом.
- Данная гарантия не распространяется на аксессуары, включавшиеся в предмет поставки, к которым относятся пистолеты 8-14 и глава «Комплектацию». Упакованный прибор при первоначальном использовании. Случайный ущерб, такой как ушибы, падения, транспортировка по причинам, не зависящим от производителя.
- В случае неисправности прибор должен отправляться в уполномоченный Центр Технического Обслуживания, прилагая к гарантинному талону чек или счет – фактуру на покупку. В другом случае, гарантия не является действительной и расходы на ремонт относятся на счет клиента.

- В случае сдачи для ремонта прибор должен сохранять неизмененную конфигурацию первоначального набора. Возможные изменения внутри упаковки ставят под угрозу действительность гарантии.

РАССОЛЫ

- Расходы по транспортировке – за счет клиента.

ВНИМАНИЕ!

- Из гигиенических соображений замена и возврат исключены, так как данный прибор является оборудованием индивидуального использования.

ВНИМАНИЕ:

- Гарантия является действительной только при наличии гарантинного талона, а также чек или счет - фактура.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

МАКСИМАЛЬНЫЙ объём небулайзера	7 мл
РЕЖИМ РАБОТЫ	30 мин. работы – 30 мин. паузы
ВЕС ПРИБОРА	1.500 гр.
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	180 x 125 x 188 мм
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИБОРА	220 V –
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА	0.7 А
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2.5 бар (250 КПа)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК	8 л/мин
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	1.6 А-Т
* СКОРОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ	0.25 мл/мин
РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ	пистолет 8-А – диаметр частиц 1–10 мкм пистолет «В» – размер частиц 1–10 мкм пистолет «С» – диаметр частиц 1–10 мкм пистолет «Д» – размер частиц до 90 % составляет 1–3 мкм
МОЩНОСТЬ	160 Вт
ЧАСТОТА	50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА	90 см приблизительно 54 дБ
ИРХО	Прибор типа В Приборы для ингаляции жидкости Внимание! Отправляйте с прилагаемой документацией Переносный ток
~	
ВКЛ.	Вкл/чен
ВЫКЛ.	Выкл/чен
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	Мин. -20 °C. Макс. + 50 °C
УРОВЕНЬ БЛЯДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	Макс.: RH 90 %

Условия ГАРАНТИИ действительны только при наличии инструкции с гарантинным талоном, о том же чек или счет - фактура.

Срок гарантии - 5 лет с даты продажи.

По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания. Адрес и телефон ИЦО указаны в гарантинном талоне, а также на последней странице ИНСТРУКЦИИ.

7 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕБУЛАЙЗЕРА

8 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Срок гарантии – 5 лет с даты продажи.

Срок службы: 10 лет
По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания (ЦТО).
ЗАО «ВИТТА - Лизинг» Лицензия № 001944 от 26.05.05
по адресу: 119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 37, корп. 2,
тел. +7 (495) 981-88-73.
с 10.00 до 18.00 по рабочим дням.

Эксклюзивный дистрибутор в России и странах СНГ
ЗАО «ВИТТА - Лизинг»
119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 37, корп. 2,
тел. +7 (495) 981-88-73.

Произведено в Китае: